




„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. ”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

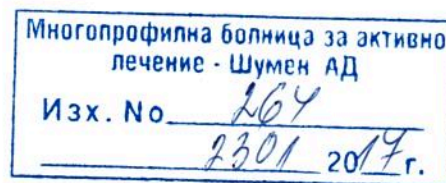

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В ”МБАЛ – ШУМЕН” АД се получи искане за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: **„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД” с Вх. № 222/19.01.2017 г. със следното съдържание:**

„Относно: Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

Уважаеми д-р Атанасов,

Във връзка с обявената от Вас в АОП обществена поръчка № 00444-2017-0001 за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД бихме желали да помолим за разяснение по техническата спецификация на **ОП № 1 Респиратор:**

1. Какво означават изписаните от Вас като абrevиатура режими на механична вентилация: VCV, PCV, PSV/CPAP, SIMV(VCV) + PSV, SIMV(PCV) + PSV, MMV + PSV, PSV + VT assured, APRV, NIV, PRVC, TCPL, TPCL + SIMV, Nasal CPAP?
2. Изискването за „Тригер поток/налягане” следва ли да се чете „Тригер поток или налягане”?
3. В изискването за *Компенсация на обемите според:*
 - Надморската височина
 - Комплайънс
 - BIPS
 - какво означава абrevиатурата BIPS?
4. В изискването за *Мониторинг на следните параметри:* какво означават следните абrevиатури: *F/VT, VD/VT, VCO₂ (STPD), PeCO₂/обем?*
5. В изискването за *Аларми* какво означават следните абrevиатури: *High/Low TV, HIV* ликаж?”

В съответствие с чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, предоставяме следните разяснения по поставените въпроси:

1. Изписаните като абrevиатури режими на механична вентилация имат следните значения:

VCV – Volume Control Ventilation;

PCV – Pressure Control Ventilation;

PSV/CPAP - Pressure Support Ventilation/Continuous Positive Airway Pressure;

SIMV (VCV) + PSV – Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation(Volume Control Ventilation) + Pressure Support Ventilation;

SIMV (PCV) + PSV - Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation(Pressure Control Ventilation) + Pressure Support Ventilation;

MMV+PSV – Mandatory Minute Volume + Pressure Support Ventilation;

PSV+VT assured - Pressure Support Ventilation + Tidal Volume assured;

APRV – Airway Pressure Release Ventilation;

NIV – Non Invasive Ventilation;

PRVC – Pressure Release Ventilation Control;

TCPL – Time Cycled Pressure Limited;

TCPL+SIMV - Time Cycled Pressure Limited + Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation;

Nasal CPAP - Nasal Continuous Positive Airway Pressure;

2. Изискването за „Тригер поток/налягане” следва да се чете „Тригер поток и налягане”.

3. В изискването за *Компенсация на обемите според*:

- *Надморската височина*
- *Комплайънс*
- **BIPS** (допусната е техническа грешка при изписването), следва да се чете **BTPS** – *Body Temperature Pressure Saturated*.

4. В изискването за Мониториране на следните параметри абrevиатурите означават следното:

F/VT - Frequency to Tidal Volume;

VD/VT – Dead Space / Tidal Volume;

VCO₂ (STPD) - Volume of CO₂ (Standard Temperature Pressure Saturated);

PeCO₂/обем - PeCO₂/обем.

5. В изискването за Аларми абrevиатурите означават:

High/Low TV - High/Low Tidal Volume;

NIV ликаж (допусната е техническа грешка при изписването) следва да се чете

NIV ликаж - Non Invasive Ventilation.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Др А

